


Устанавливается следующая структура условного обозначения:

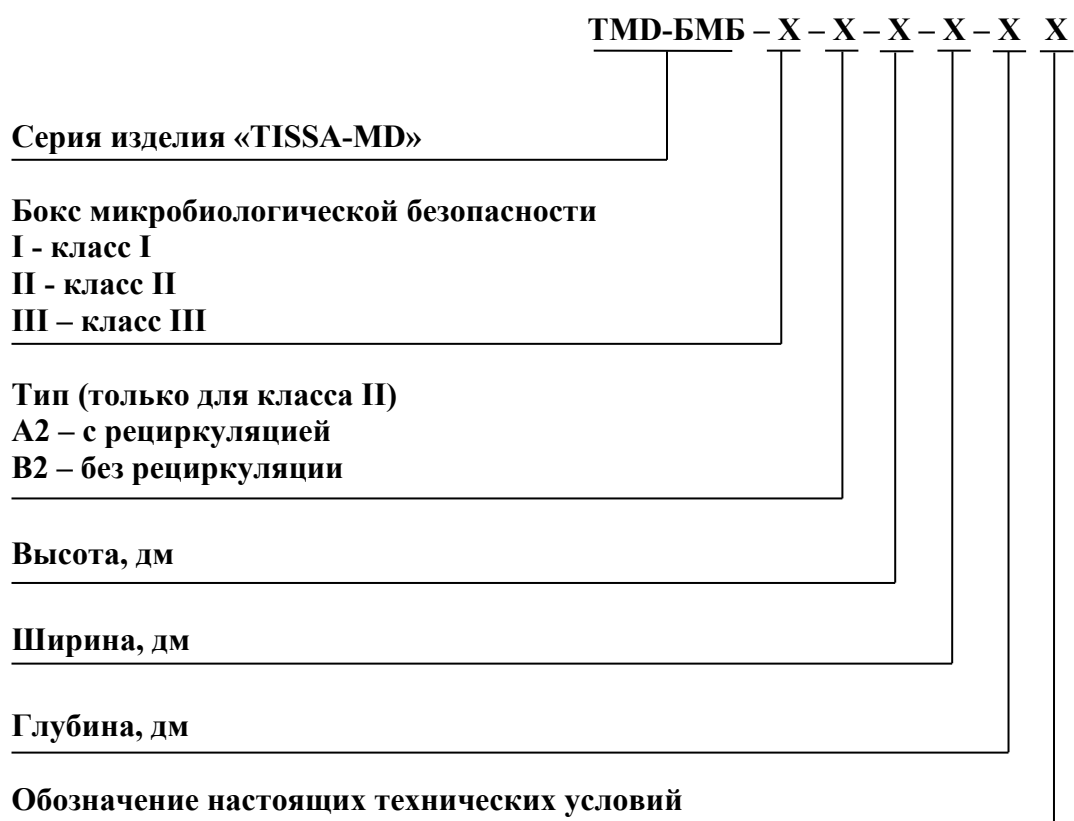

Пример условного обозначения изделия при заказе и в документации:

Бокс микробиологической безопасности «TISSA-MD» II класса, с рециркуляцией, высотой 215 дм, шириной 120 дм, глубиной 77 дм.

TMD-БМБ-II-A2-215-120-77 ТУ ВУ 600091320.032-2021